
Plan de maintenance NEURO CLASSIC 24 mm

Commission des patients/ID de configuration _____

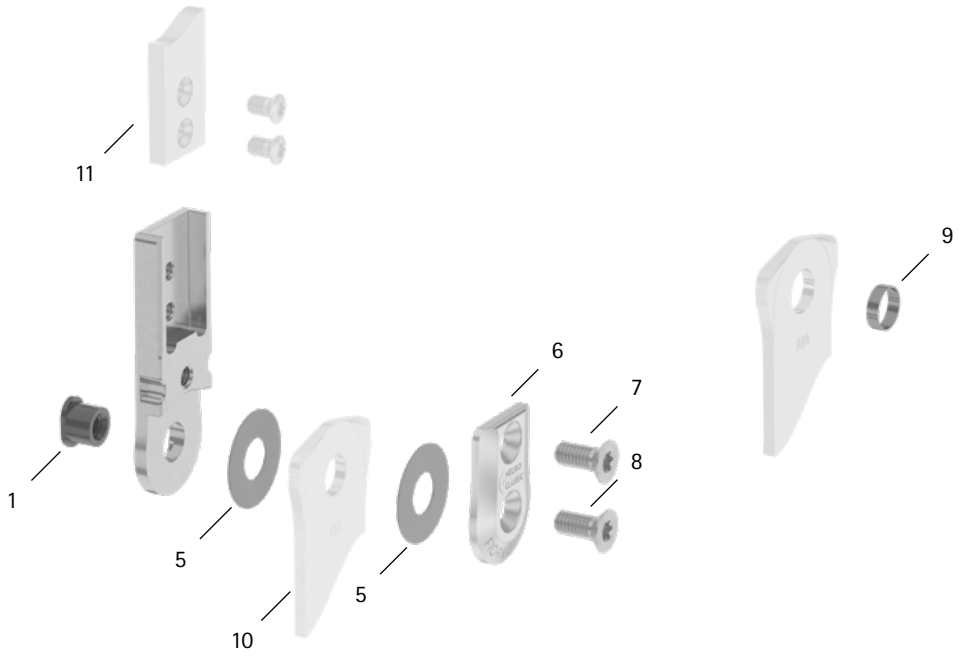

Pos.	24 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB1262-L1190	boulon à goupille fendue, court**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	GS3013-040	rondelle de friction, Ø = 30 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
5	GS3013-045					
5	GS3013-050					
5	GS3013-055					
5	GS3013-060					
6	SF0167-3/AL	plaque supérieure**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	SC1416-L16	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SC1416-L16	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
1, 6-8	SF1987-AL	ensemble fonctionnel modularité plug + go***	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
Étriers de pied modulaires, ancres modulaires et montants modulaires						
9	BR1413-L070	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
10	voir catalogue	étrier de pied modulaire	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	48 mois
11	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient
** fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel
*** composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément

WP0134-FR-2026-09